


Artefakter i ultraljudsbilden


HL1202 Medicinska bildgivande system

- A och B är homogena ickespridande material
- C är inhomogent spridande material
- F har stor dämpning
- G har mkt hög impedans jämfört med B
- A, B, C, D, E, F, G, H, I och J har alla olika akustik impedans


Avbildningsobjekt

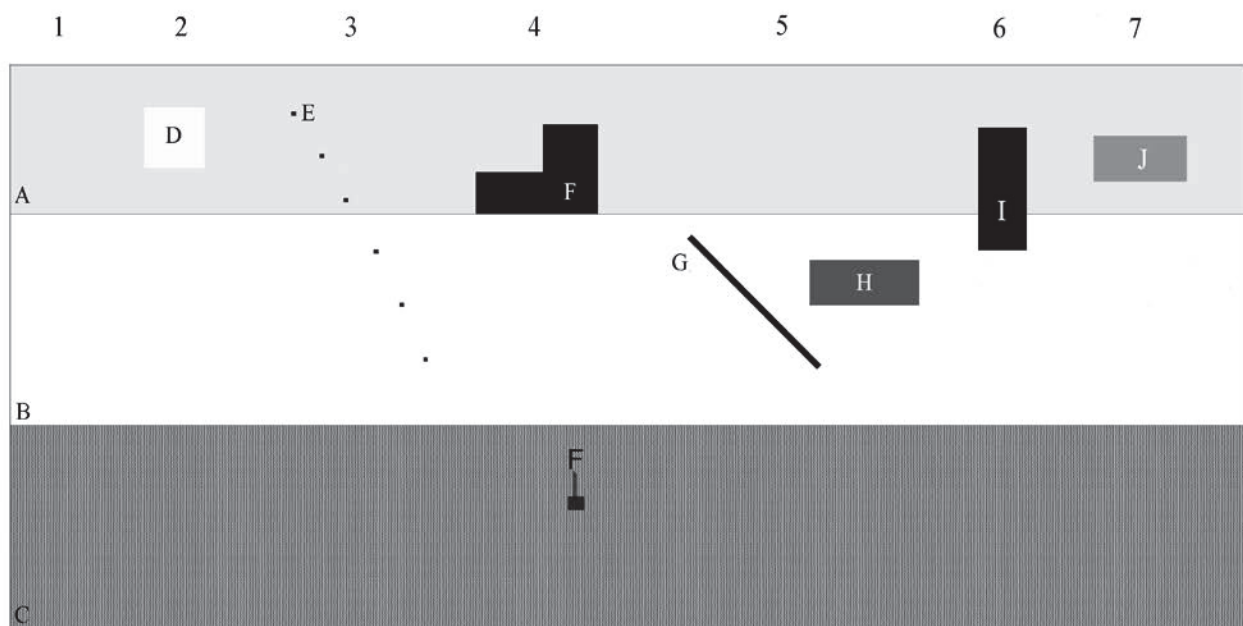


Avbildning

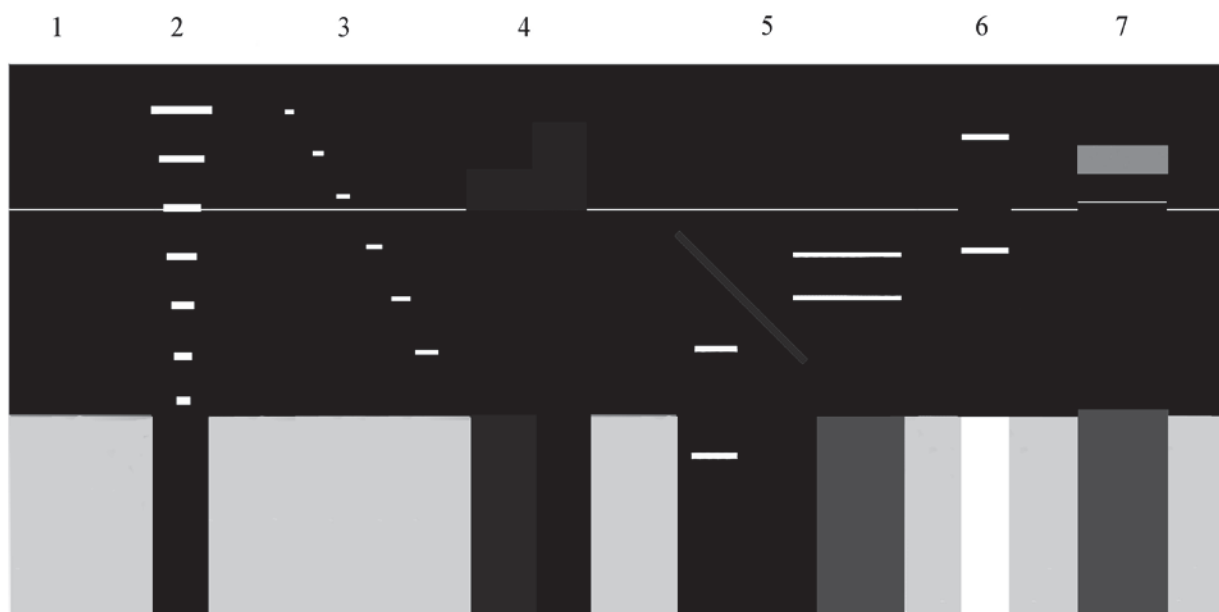


Gallblåsa

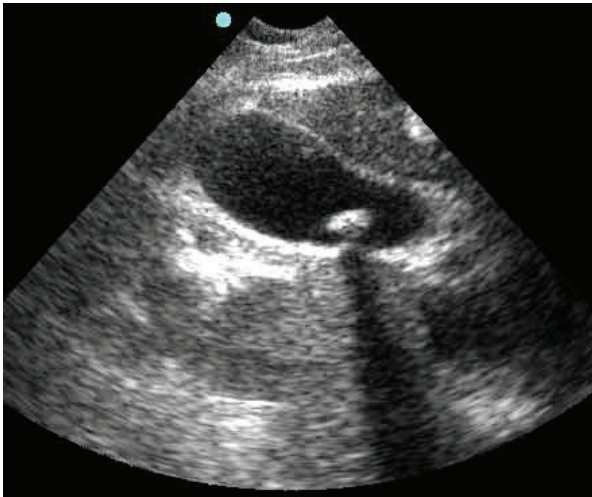

Lever

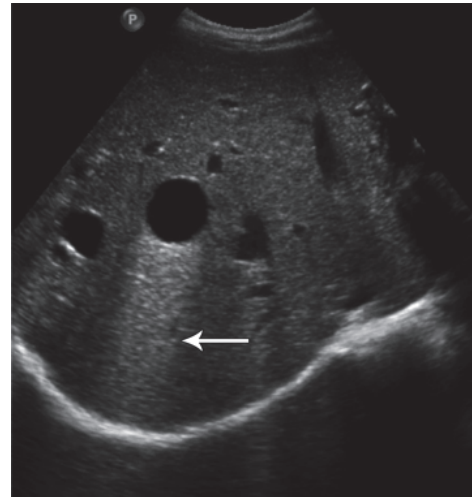

Lever

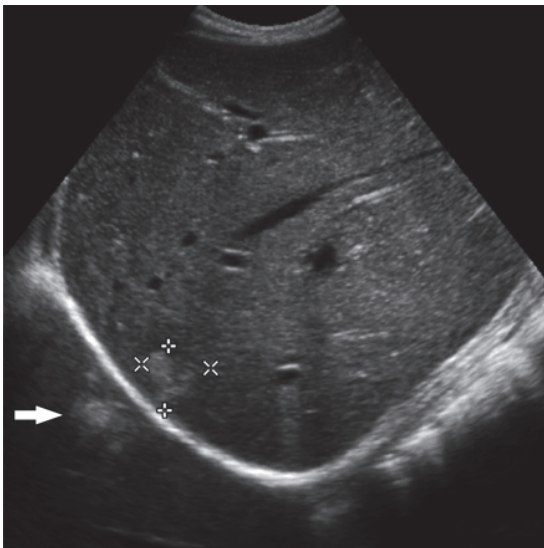

Lunga

